


救急活動中の事故に係る専決処分の報告について

1. 事故発生日時	令和 6 年 7 月 1 9 日（金） 午後 0 時 1 8 分頃
2. 事故発生場所	宇治市槇島町一ノ坪 1 4 番地 1
3. 事故の概要	傷病者をストレッチャーで屋外に搬送する際、ストレッチャー後部（足側）を設置されていたパーティションに接触させ、パーティションの表面の一部を破損したものです。
4. 損害賠償の相手方	
5. 示談締結日	令和 6 年 8 月 2 7 日
6. 損害賠償の額	2 2, 0 0 0 円

現場付近見取図

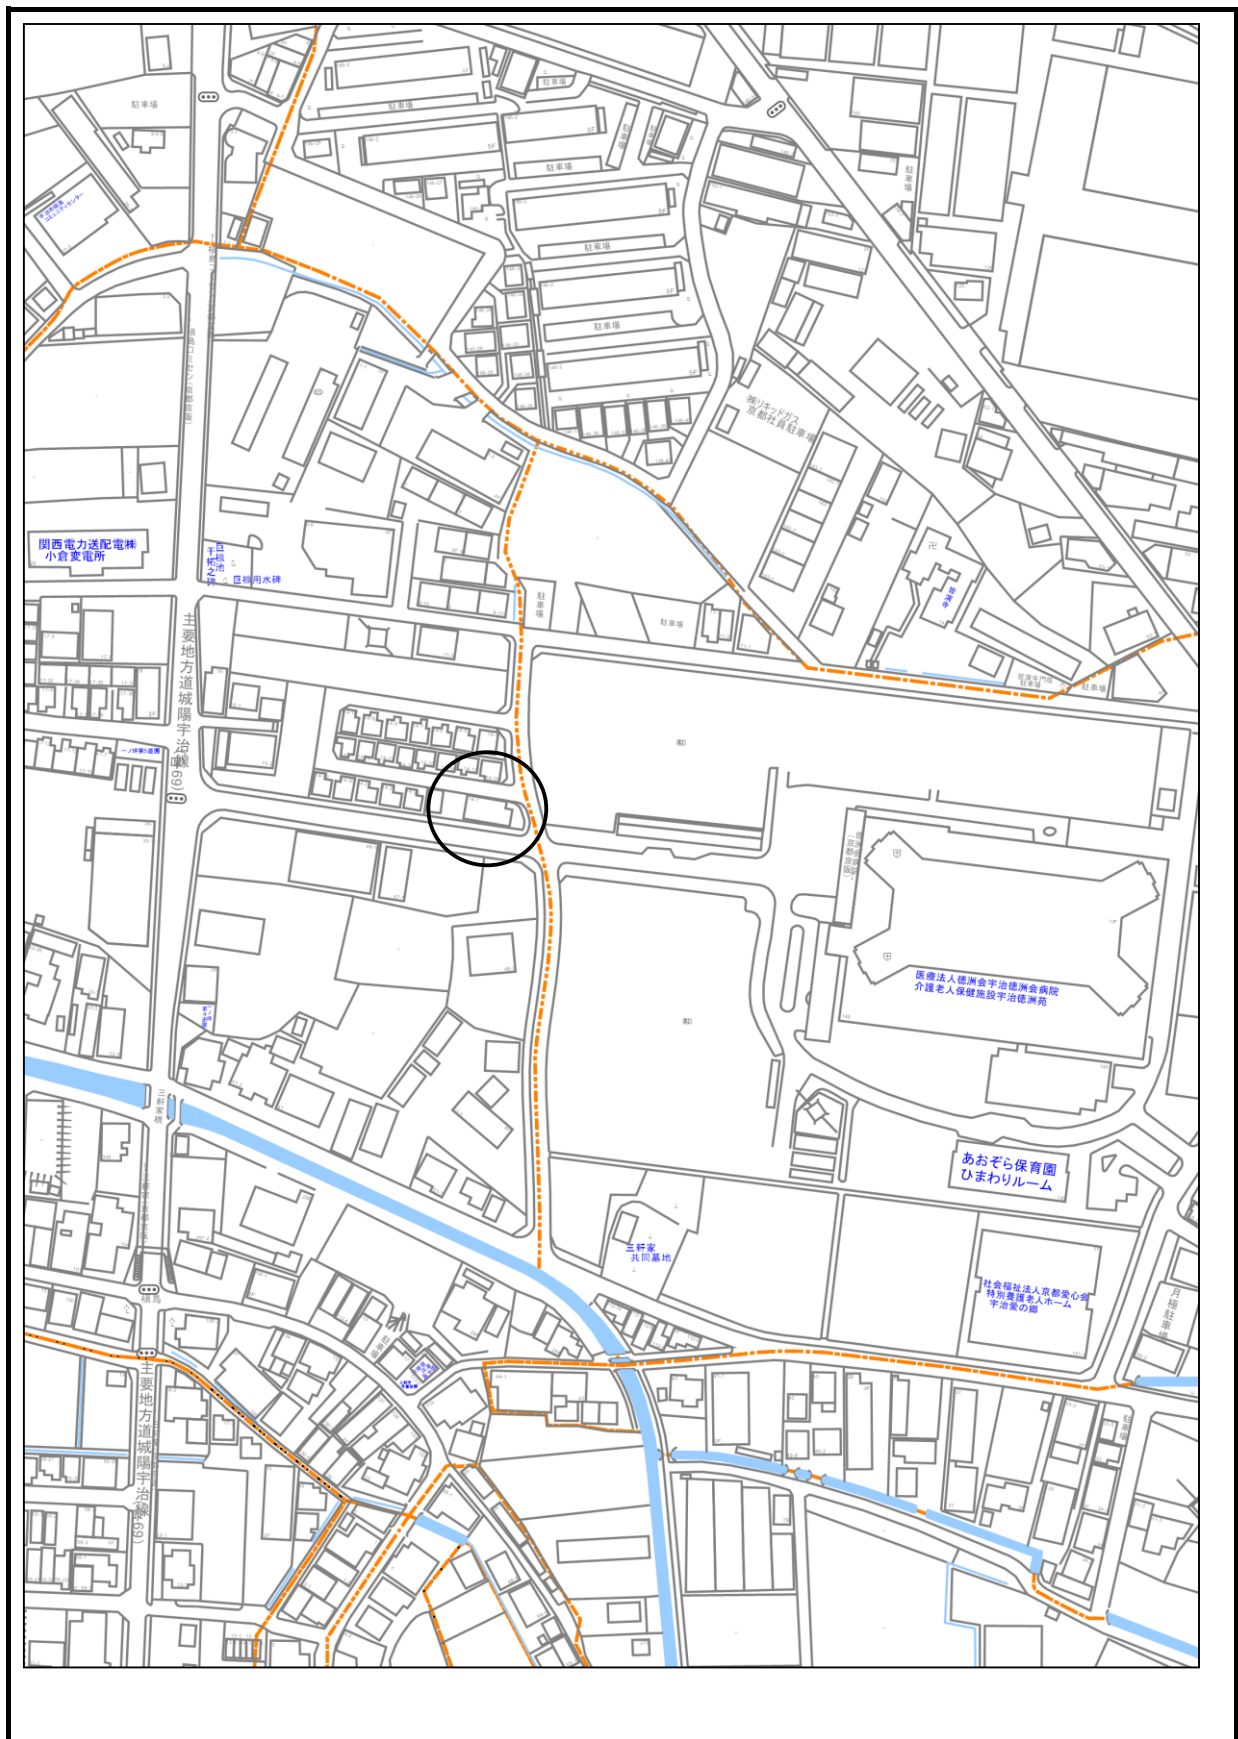

①使用したストレッチャー サイズと接触部位



主材質	アルミニウム
メインホイール 外径	150mm
幅	44mm
全長	2050mm
全幅	570mm
最大荷重	200kg ※RS-Jは181kg
全高	
ポジション6（最高位）	1050mm
ポジション5	930mm
ポジション4	830mm
ポジション3	720mm
ポジション2（CPR）	510mm
ポジション1（最低位）	495mm
搬入ポジション	405mm
重量	60.5kg


②玄関から見た状況




③内部から玄関及び接触箇所を見た状況



④破損箇所の状況（拡大） 破損箇所の高さ 1000 mmはストレッチャーで搬送時の高さとも一致し、これより下はカーテンがパーティションを覆っており、傷病者搬送時は視認しづらい状況であった。

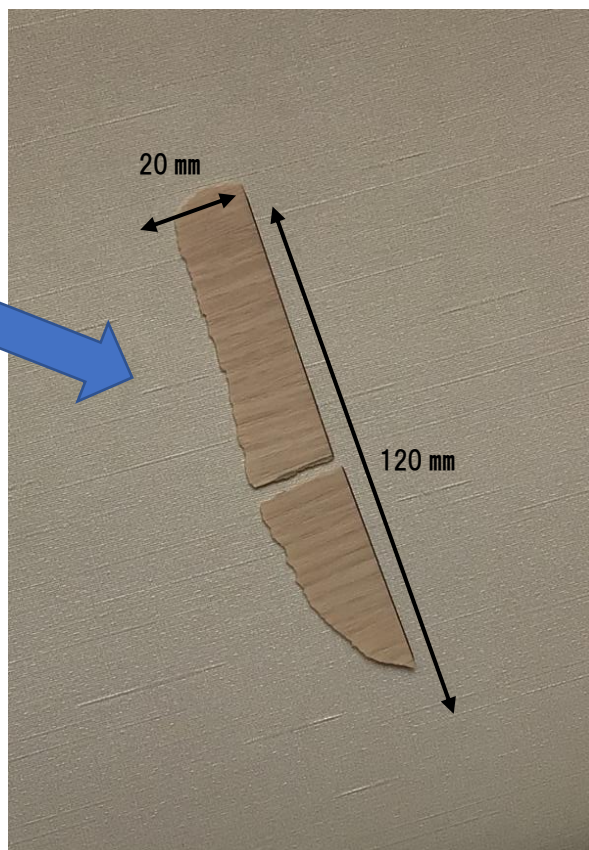

⑤通路幅（事故時、左側全ての椅子に着座されている状況であった。）

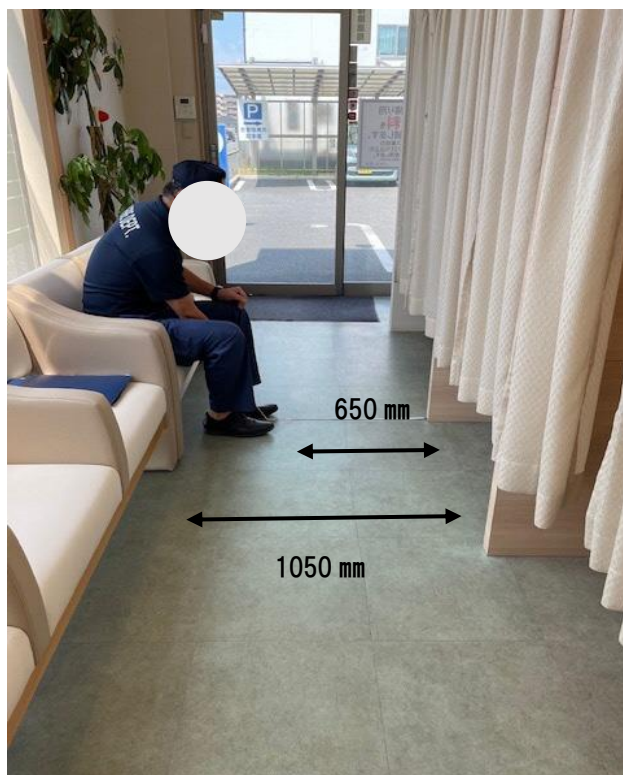

⑥着座されている方の足を除くと約 650 mmの幅を全幅 570 mmのストレッチャーで通過した。

